
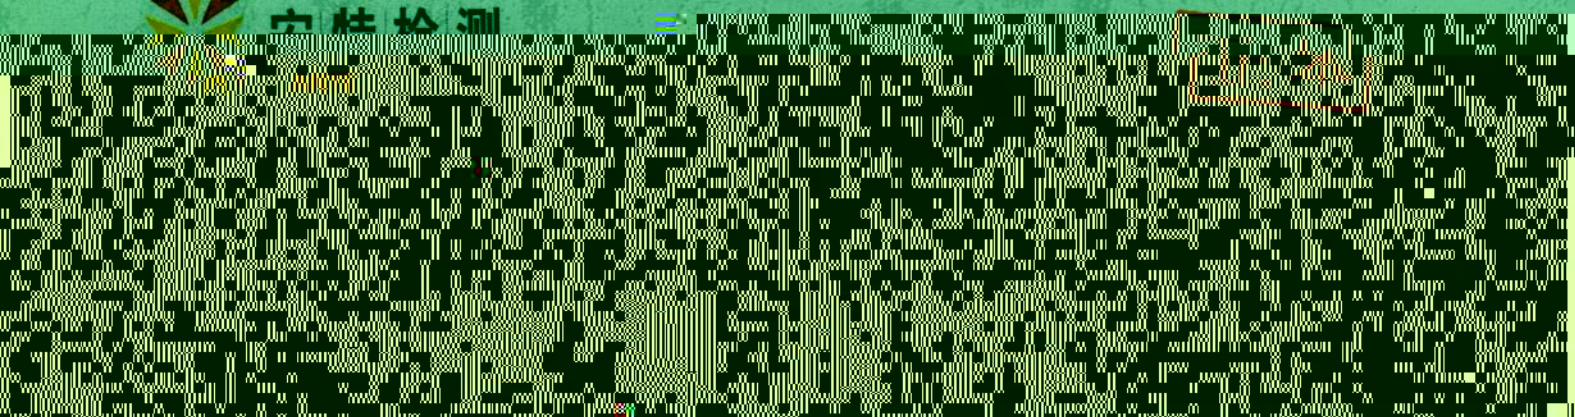
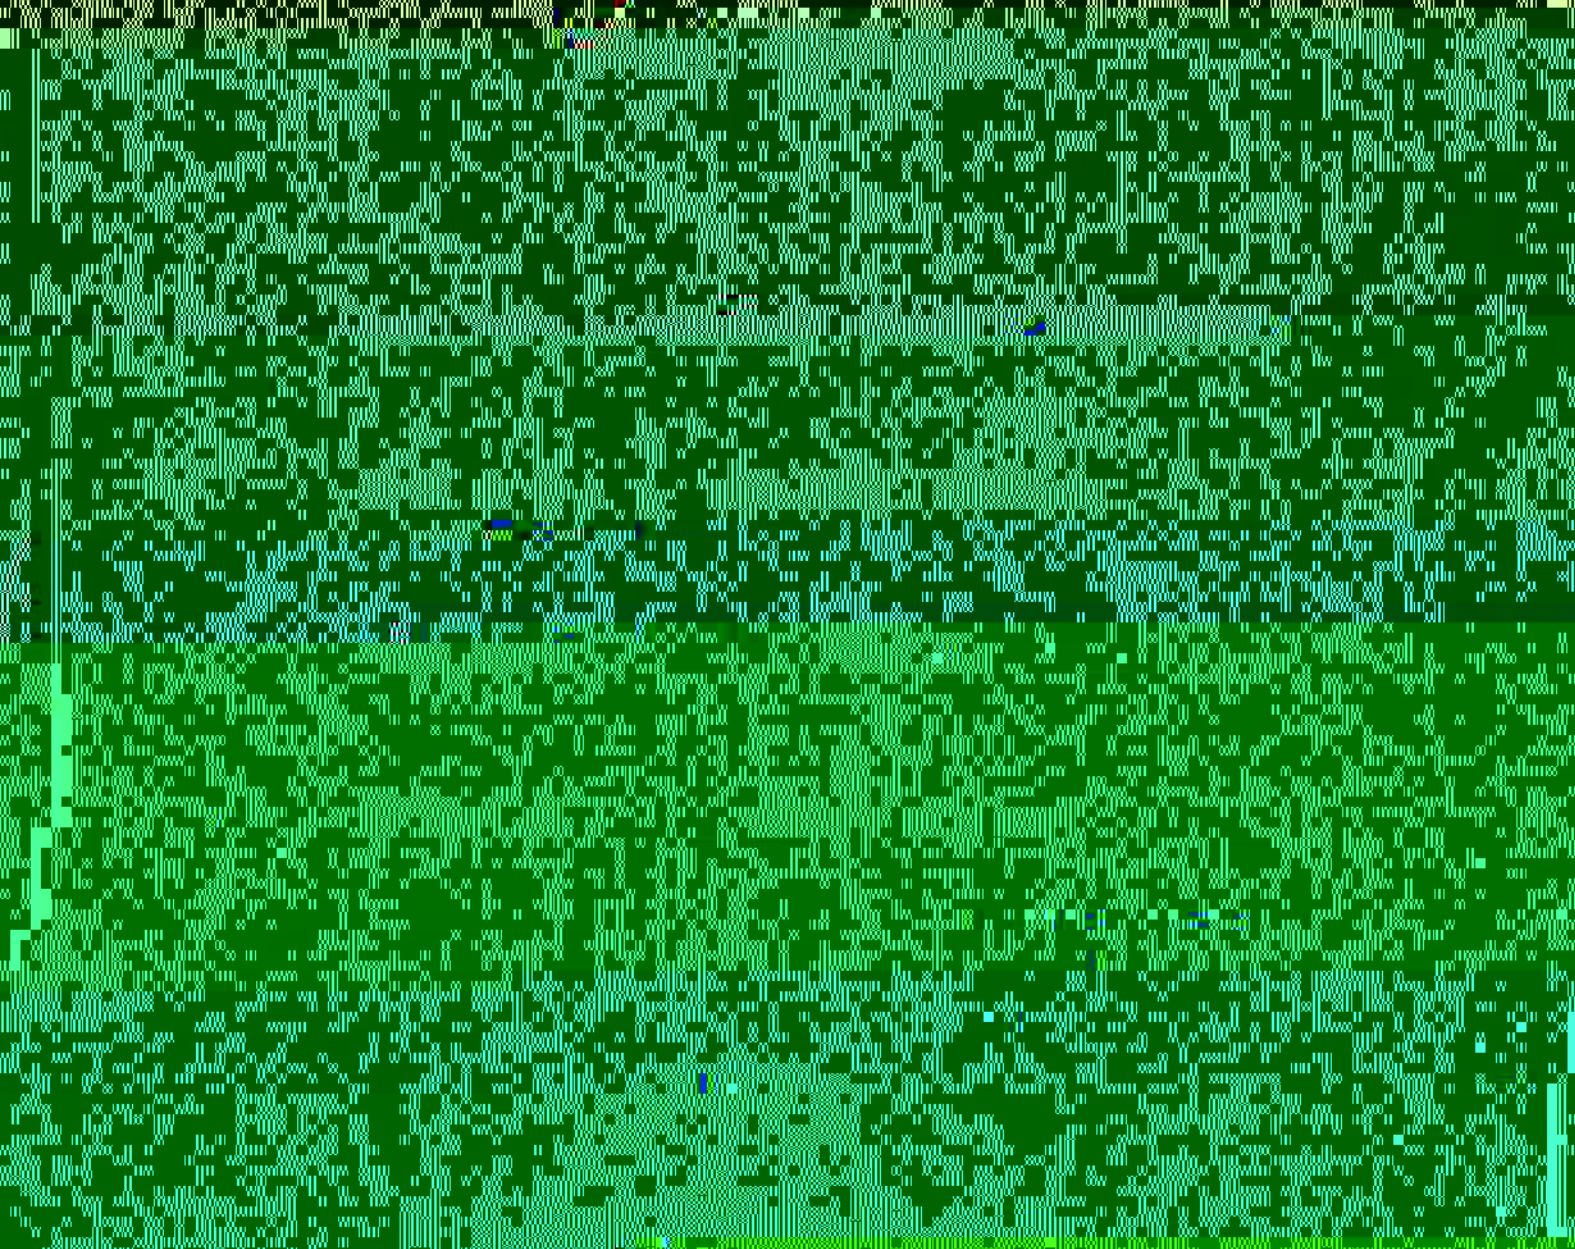


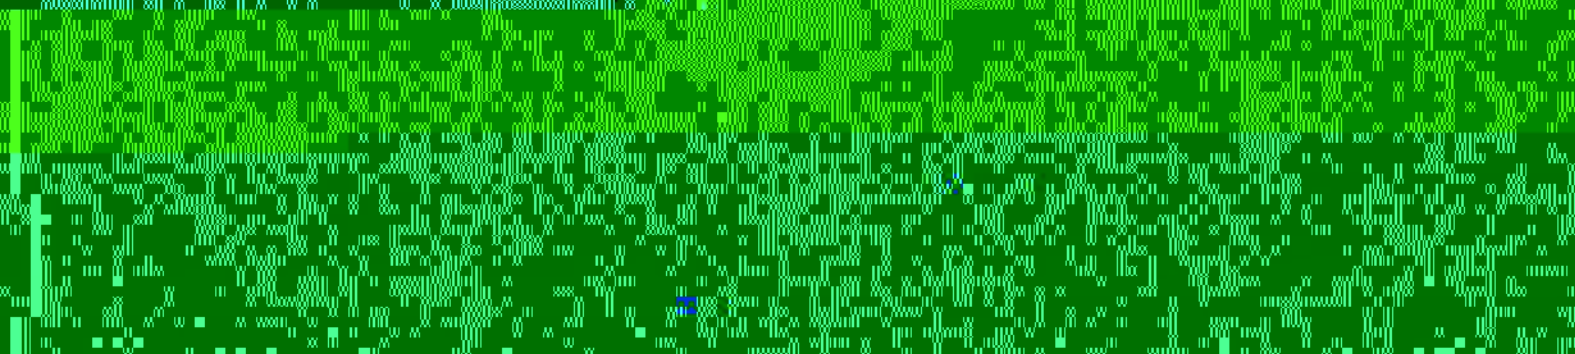

注意事项


1、报告无“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。

2、报告涂改无效。报告无编制、审核和授权签字人签名无效。

在中餐, 适用于中餐的, 视为认可本报告。

5、中委并单位自行采集的样品, 本公司仅对送检样品的检测结果负责, 不

山东安泰特检认证有限公司

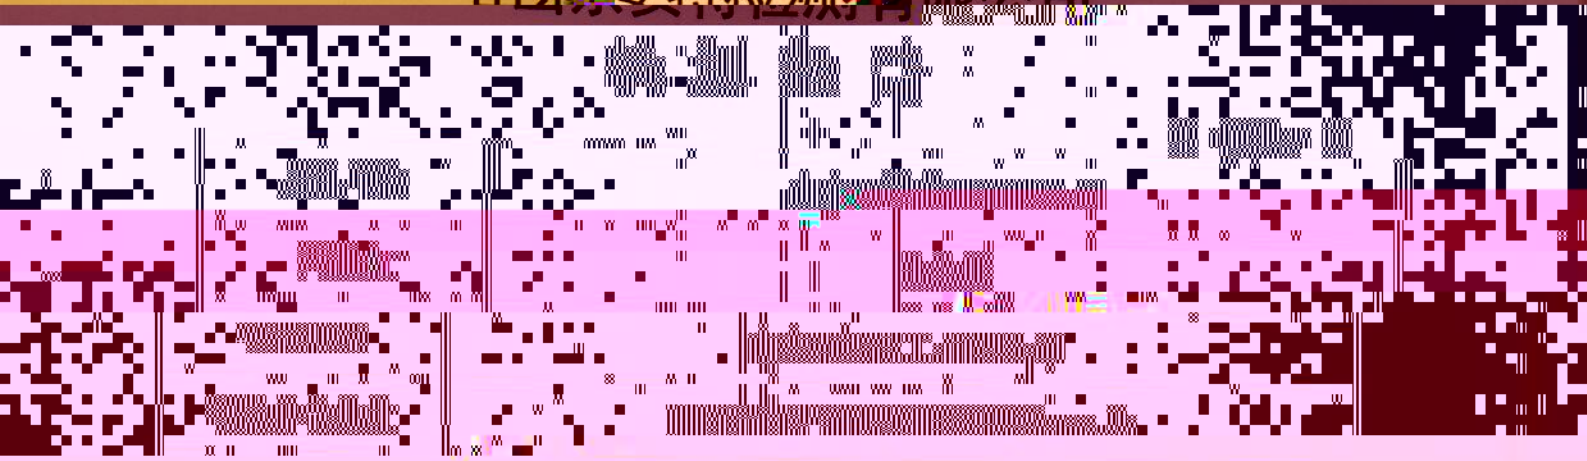

山东安特检测有限公司



山东安特检测有限公司 检 测 报 告

第 3 页共 5 页

表 4-1 废水（COD_{Cr}）自动监测设备比对监测结果

排污企业名称		山东万达化工有限公司			现场监测日期		2024.10.11	
测点名称		污水排放口 WY001			万研台期		2024.10.11	
浓度		80%			样品类型		废水	
测试项目		CODcr			自动仪器现场测量范围		10~1000 mg/L	
标准样品编号		仪器测试时间	自动仪器测定值 (mg/L)	标准样品浓度 (mg/L)	绝对误差 (mg/L)	标准限值	结果评定	
		10:27	26.130	1.130	±5	合格		
自配		11:16	26.335	1.335	±5	合格		
		12:08	26.130	1.130	±5	合格		
备注		CODcr<30 mg/L 时 (用浓度为 20~25mg/L 标准样代替实际水样进行测试)						

项目	数据上传	测试结果	标准样品信息	标准样品浓度	标准	备注
----	------	------	--------	--------	----	----

山东安特检测有限公司
检测 报 告

第 4 页 共 5 页

表 4-2 废水(氨氮)自动监测设备比对监测结果

排污口名称

山东安特检测有限公司

检测报告

附件 1: 在线数据照片


2024-11-01

0031

0031

0031 0031 0031

0031

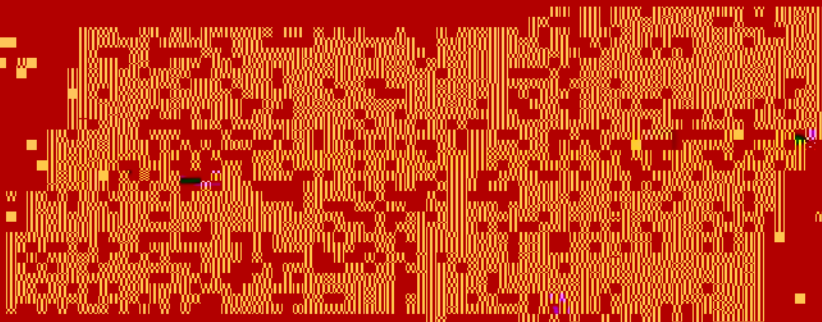

0031

0031

0031

0031

0031

0031

0031

0031

0031

0031

采样日期: 2024.10.11
采样类别: 自取

采样点位置

样品

H2024
1

H2024
4

H2024
2

H2024
5

H2024
3

H2024
6

备注

G: 硬质玻璃瓶
P: 聚乙烯桶 (瓶)

保存条件:
1. 避光
2. 低温
3. 密封

抗坏血酸
1. 避光
2. 低温
3. 密封

仪器型号
1. 避光
2. 低温
3. 密封

现场检测
1. 避光
2. 低温
3. 密封

91.2-1
1. 避光
2. 低温
3. 密封

pH 计校准信息

校准项目
检测浓度

采样人员:

李强

分光光度法测定原始记录表

检测项目：氨氮(以N计)		检出限：0.025mg/L	温度(℃)：24.3	湿度(%)：52	
采样/送检日期	2024.10.11	分析日期	2024.10.12	仪器名称	紫外可见分光光度计
检测依据	HJ 535-2009水质 氨氮的测定				

化学需氧量测定原始记录表

AT/JL/QP26/H005-5A

检测项目	化学需氧量 (COD _{Cr})	检出限:	4mg/L	温度(℃):	23.5	湿度(%):	42
采样/送检日期	2024.10.11	分析日期	2024.10.12				
采样人							
送检人							
接收人							
预处理	取适量水样于锥形瓶中,依次加入硫酸汞、重铬酸钾标准溶液5.00mL,将锥形瓶连接到回流装置冷凝管下端,从冷凝管上缓慢加入15mL硫酸银硫酸溶液,自开始沸腾开始保持微沸2h,回流冷却后自下端加入45mL水,冷却至室温并保温。						

