


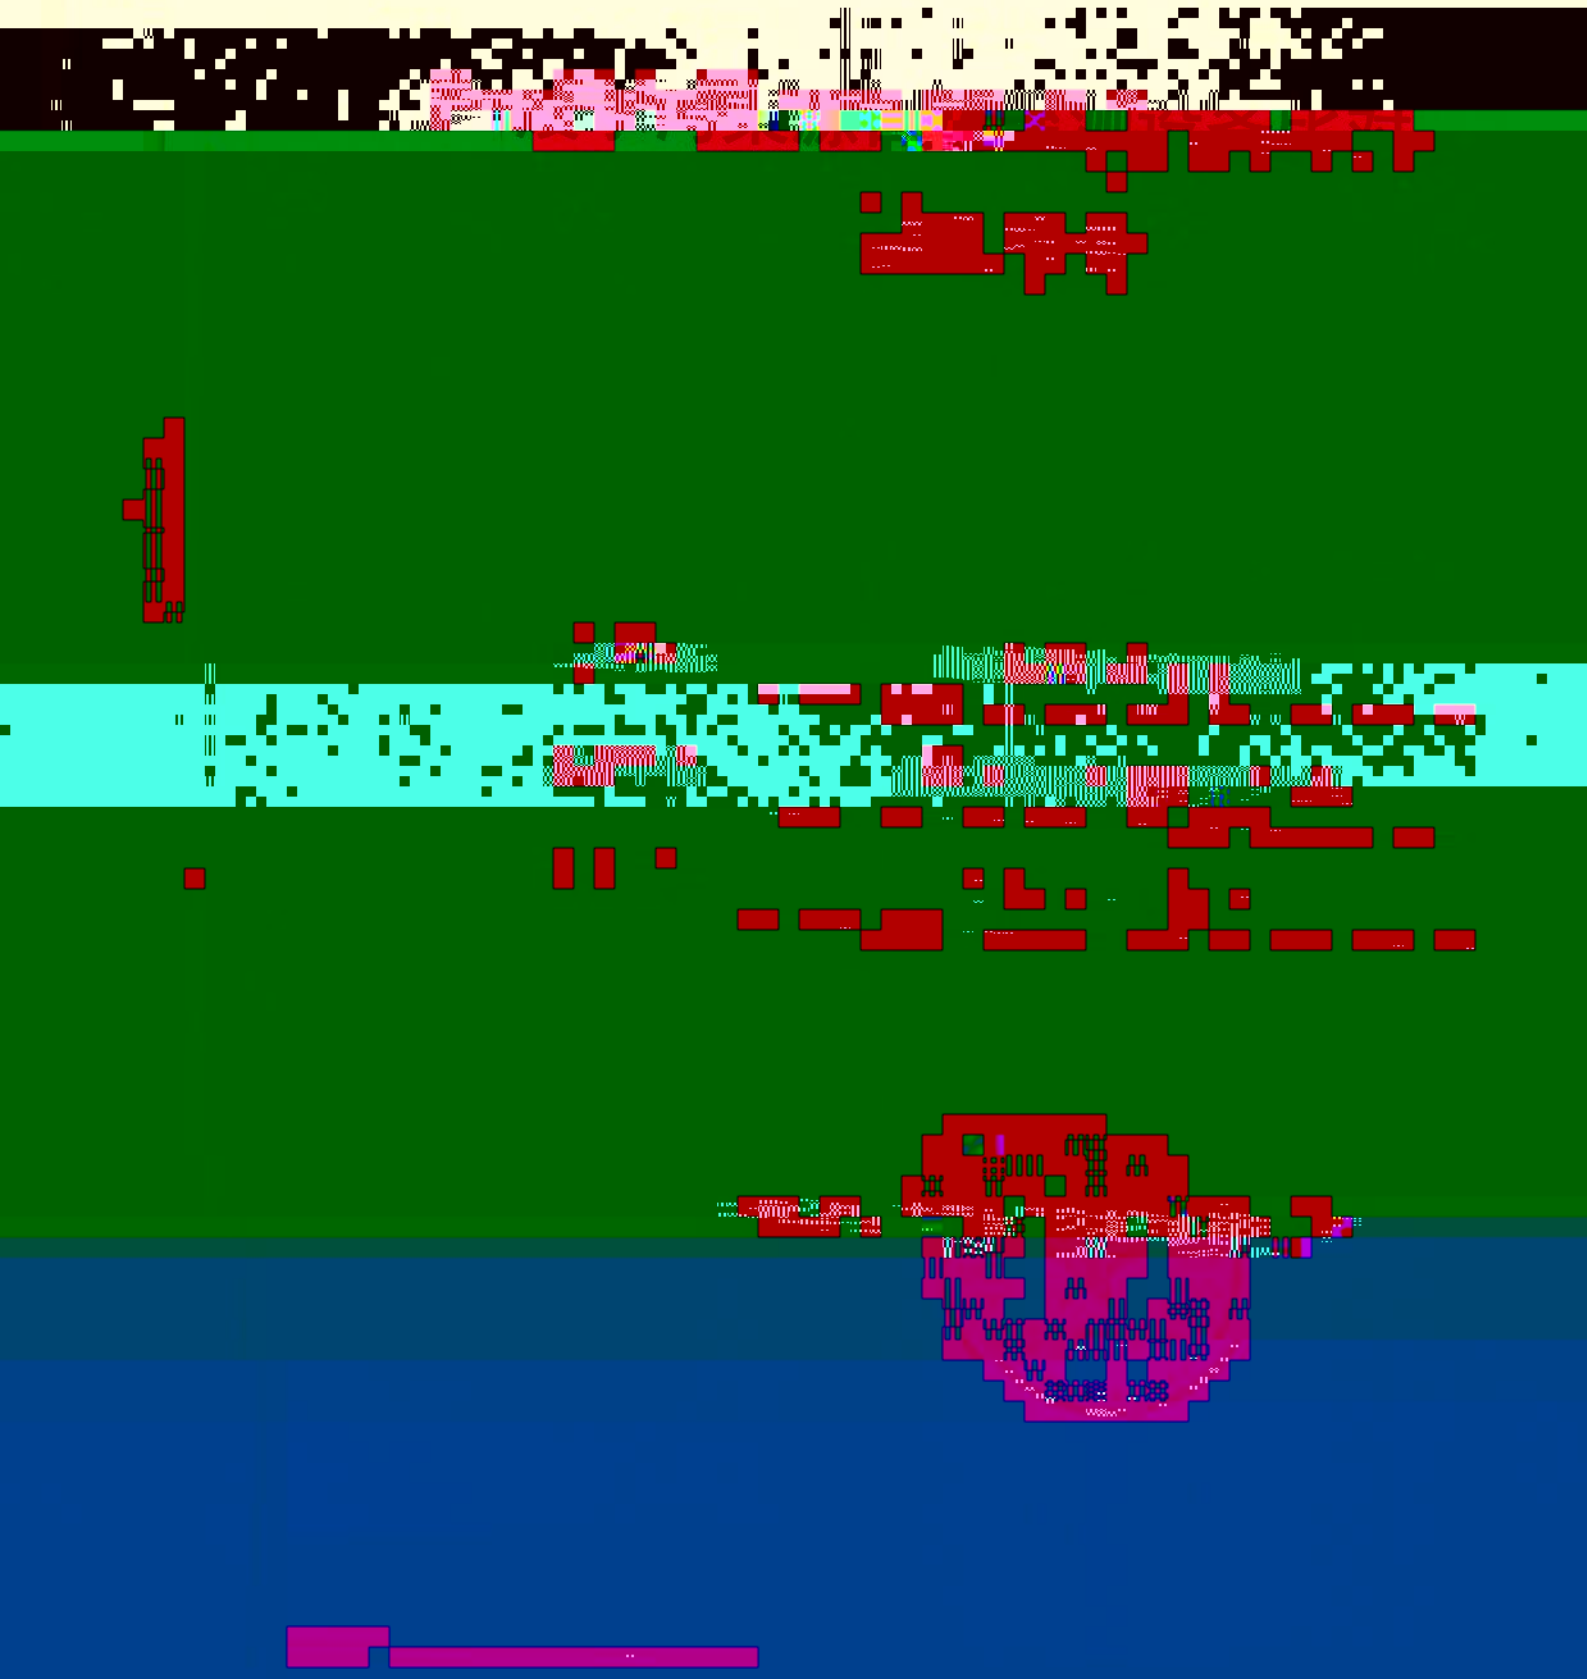

一、概况

企业名称:	山东威特化工有限公司		
水污染源在线监测系统安装位置:	DW001 污水总排口		
生产厂家:	山东龙发环保科技有限公司	山东龙发环保科技有限公司	安徽英锐环境技术有限公司
设备型号:	COD _{Cr} :LFH2001	NH ₃ -N:LFH2013	超声波明渠污水流量计:Flowlyzer1220 型
原理:	重铬酸钾氧化分光光度法	纳氏试剂分光光度法	超声波回声测距法
比对监测日期:	2025.04.23		

二、依据

- (1) HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》
- (2) HJ 355-2019《水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）运行技术规范》
- (3) HJ 356-2019《污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N 等）数据有效性判别技术规范》
- (4) HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》
- (5) HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》



废水污染源自动监测设备比对监测结果表

排污企业名称	山东恒邦冶炼股份有限公司	现场监测日期	2025.01.26
监测名称	DW001废水氨氮	监测时间	2025.01.26
监测点	90%	样品名称	废水
测试项目	氨氮	仪器量程范围	0-90mg/L
原始记录编号			

标准编号	测试时间	测定值 (mg/L)	绝对误差 (mg/L)	标准限值	标准样品批号	标准样品 浓度范围 (mg/L)	结果判定
QC-NH ₃ -N-1	10: 17	42.889	-4.69	±10%	B240420511	45	合格

样品编号	测试时间	测定值 (mg/L)	测定值 (mg/L)	相对误差	标准限值	结果判定
250107W01-09WS111	10: 53	2.643	2.63	8.17	±15	合格
250107W01-09WS112	11: 40	2.789	2.89	-3.49	±15	合格
250107W01-09WS113	12: 31	2.532	2.69	-5.87	±15	合格

技术说明

	方法	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
自动仪器	纳氏试剂分光光度法	水质氨氮(NH ₃ -N)在线监测仪	LFH2013	21020106	0.02mg/L
手动仪器	纳氏试剂分光光度法	紫外分光光度计	UV-5200	AF2110001	0.025mg/L
比对结果	氨氮经过比对合格。				

注 意 事 项

- 1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3.对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本报告签发单位提出，逾期不予受理。
- 4.不可重复性试验不进行复检。
- 5.若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。
- 6.未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
- 7.未经本单位同意，不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。
- 8.本报告涂改无效。

通讯地址：山东省东营市开发区东五路1号1幢

邮政编码：257000

联系电话：18678675114